


# PSYCHROMETR AUGUSTA

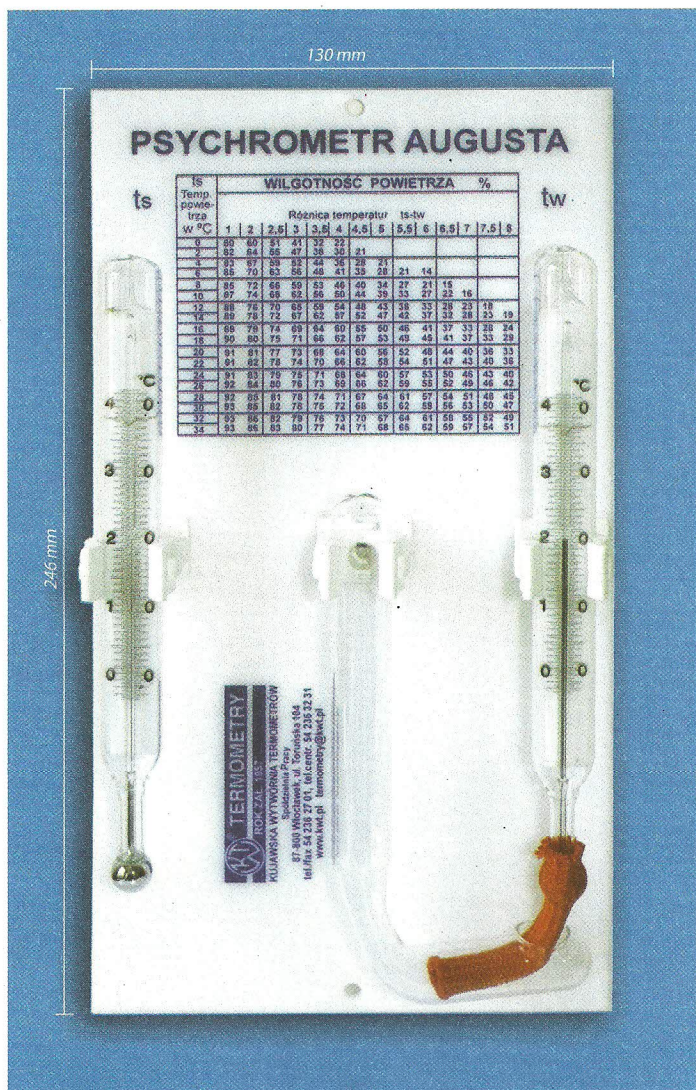

Psychrometr Augusta służy do pomiaru wilgotności w pomieszczeniach zamkniętych z naturalnym przepływem powietrza. Wyposażony jest w dwa identyczne termometry o zakresie temperaturowym 0+40°C, działce elementarnej 0,5°C. Psychrometr posiada zbiornik z wodą, który nawilża jeden z termometrów poprzez bawełnianą koszulkę.

Odczytu wilgotności względnej dokonuje się na podstawie różnicy temperatur termometru suchego i wilgotnego w/g umieszczonej tabeli. Tabela wilgotności została opracowana na podstawie publikacji Ananiasza Rojeckiego – Tablice psychrometryczne – Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego, wydanie z 1959 roku.

Łatwość montażu termometrów i zbiorników na wodę pozwala na ich wymianę. W przypadku uszkodzenia, elementy te można zakupić u wytwórcy psychrometru.

Na życzenie klienta termometry mogą posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium PCA\*.

Oferta kierowana jest do:

- hodowców grzybów jadalnych, np. pieczarkarnie
- serowarni
- młynów zbożowych
- zakładów zielarskich
- wytwórni win
- zakładów farmaceutycznych
- aptek
- przechowalni warzyw i owoców
- kopalni soli
- suszarni

Termometry do psychrometru wykonane są zgodnie z Branżową Normą **BN-78/5531-30**

Zbiornik na wodę można wysunąć z uchwytu celem napełnienia wodą.

\* Polskie Centrum Akredytacji

Kod psychrometru Augusta: 023PSYCHROMETRAUGUST



## TERMOMETRY

ROK ZAŁ. 1957

KUJAWSKA WYTWÓRNIA TERMOMETRÓW Spółdzielnia Pracy

87-800 WŁOCŁAWEK ul. Toruńska 104

POLAND

tel./fax:

tel. centr.:

tel. dz. handlowy:

www.kwt.pl:

e-mail:

e-mail działu sprzedaży:

(54) 236-27-01

(54) 236-32-31

wewn. 32 lub 46

termometry@kwt.pl

handlowy@kwt.pl

KONTO BANKOWE

PKO BP S.A. o/Włocławek 90 1020 5170 0000 1102 0065 2776

KRS:

00000 81378

NIP:

888-020-05-79

NIP UE:

PL 8880200579

REGON:

000401147